

Set de verificación de calibración cloro libre
HI701-11



Descripción

El set de verificación de calibración cloro libre Checker ® HC ® **HI701-11** proporciona una solución simple para validar el cloro libre Checker ® HC ® **HI701** en el rango de 0,00 a 2,50 ppm (mg/L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para brindar trazabilidad al certificar el Checker ® HC.

Especificaciones

Empaque	Cubeta
Cantidad	1 set
Certificado de análisis	Si

Accesorios

- Checker de Cloro libre **HI701**

Cómo pedir

El set de verificación **HI701-11** se entrega con una cubeta cero (1), cubeta 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre @25°C (1) y certificado de análisis.

Ventajas


El **HI701-11** es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el cloro libre **HI701**. El **HI701-11** incluye una cubeta sellada para cero ppm de cloro libre y una cubeta teñida a una muestra de cloro libre equivalente a 1,00 +/- 0,05 ppm a 25 ° C. Instalación de fabricación de última generación que utiliza productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

-Valor estándar de 1,00 +/- 0,05 ppm de cloro libre a 25 °C.

-Reutilizable con estabilidad de larga vida útil.

-El HI701-11 se suministra con certificado de análisis

- Código de producto.
- Número de lote.
- Fecha de caducidad.

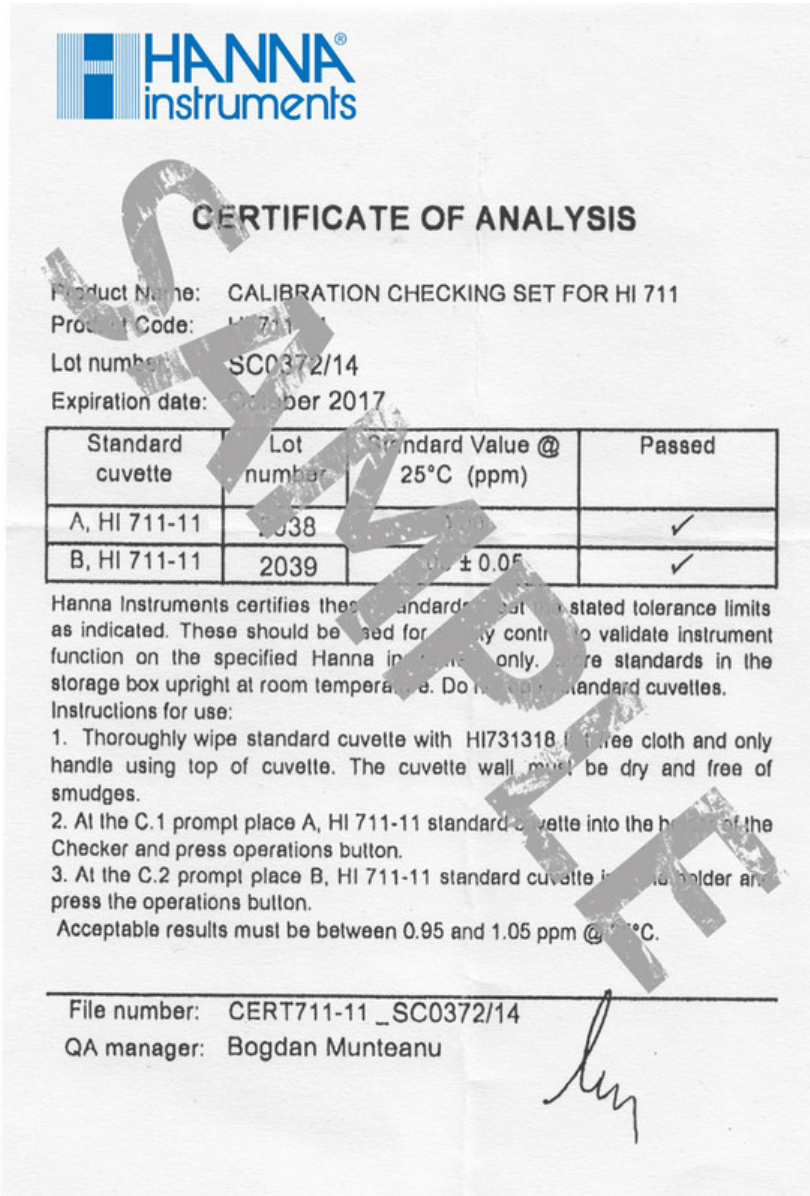

Video

No Especifica